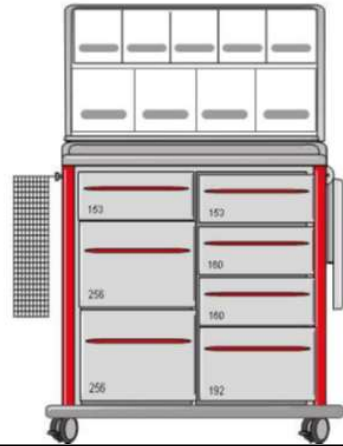
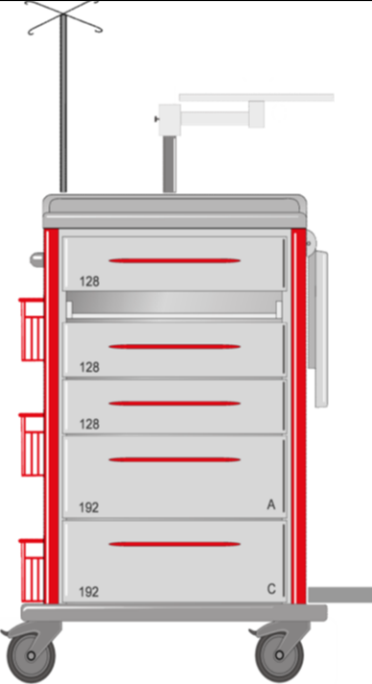
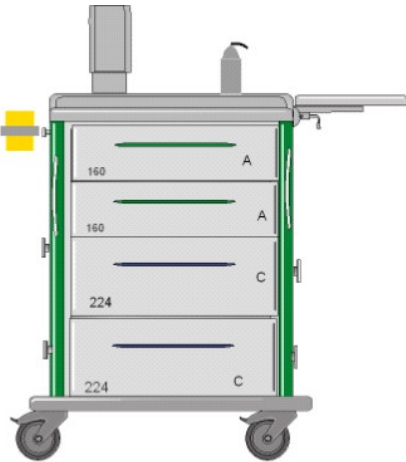
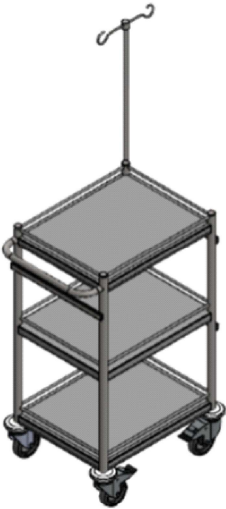


SKLOP	Oddelek	Naziv artikla	Tehnične zahteve	Slika je simbolična
1	Anestezija	VOZIČEK ANESTEZIJSKI	Material: aluminij in plastika, ABS, omogoča lahko in učinkovito čiščenje in razkuževanje, zaobljena oblika delovne površine onemogoča nalaganje prahu in umazanje ter štiti pred udarci. Ogrodje vozička mora biti v celoti iz aluminijastega ohišja, kar zagotavlja največjo moč in stabilnost. Delovna površina vozička mora biti ergonomsko oblikovana, iz ABS materiala, zadaj in ob straneh naraščajoče dvignjena, omogoča varno rokovanje z zdravili ter onemogoča prevračanje in polivanje tekočin pri transportu vozička. Dimenzije vozička: •Višina s kolesi 900 mm •Širina vozička z zaščito pred poškodbami 949 mm, dolžina delovne površine 860 mm •globina z zaščito pred poškodbami, 680 mm, globina delovne površine 580 mm Predali vozička: na levi strani 3 predali (153, 256 in 256mm), na desni strani 4 predali (153, 160, 160 in 192 mm) – višine naštetje od zgoraj navzdol. Vsi predali opremljeni z visokokakovostnimi vodili in kakovostnim vakuumskim samozapiralnim mehanizmom. Varnostni mehanizem za zaščito pred prevračanjem: ko je prvi predal odprt, se lahko hkrati odpre le še en predal. Hrbtna stran: 4 električne vtičnice, fiksirane, poleg dvojna kljuka za električni kabel. Na hrbtni strani pritrjeno aluminijasto ogrodje Haberle, s tipper plastičnimi kontejnerji (5 malih zgoraj, 4 veliki, spodaj). Ogrodje Haeblerle mora biti pritrjeno nad delovno površino vozička. Desna stran vozička: dodatna dvizna delovna mizica z zatičem, ki se enostavno spusti ali dvigne. Leva stran vozička: aluminijasta konzola z mrežasto košaro za katetre. Zaščita pred poškodbami: voziček mora biti spodaj v celoti obdan z zaščito pred poškodbami, ki je široka toliko, da zajame ogrodje, in ročaje zaprtih predalov. V primeru trka mora biti onemogočena poškodba ogrođa ali odstranitev barve vozička. Kolesa: voziček naj bo opremljen z dvojnimi antistatičnimi kolesi premera 110 mm, ki ne puščajo sledi, pomičnimi v vse smeri, dve kolesi morata imeti zavoro. Barva vozička: ogrodje svetlo sivo, stranice in ročaji rdeči.	
2	Pedriatrija	VOZIČEK ZA REANIMACIJO, VEČJI (INTENZIVA, ANESTEZIJA in PEDIATRIJA)	Material: aluminij in plastika (ABS materiala), omogoča lahko in učinkovito čiščenje in razkuževanje, zaobljena oblika delovne površine onemogoča nalaganje prahu in umazanje ter štiti pred udarci. Ogrodje vozička mora biti v celoti iz aluminijastega ohišja, kar zagotavlja največjo moč in stabilnost. Delovna površina vozička mora biti ergonomsko oblikovana, iz ABS materiala, zadaj in ob straneh naraščajoče dvignjena, omogoča varno rokovanje z zdravili ter onemogoča prevračanje in polivanje tekočin pri transportu vozička. Dimenzije vozička : - višina vozička s kolesi: 1060 - 1130 mm, - dolžina: 700 - 800 mm z zaščito pred poškodbami, - širina : 560 - 600 mm, z zaščito pred poškodbami. Na levi bočni strani morajo biti nameščene: tri aluminijaste mrežaste košare za pripomočke in razkužila, ročaj za pomikanje vozička. Na desni bočni strani vozička mora biti nameščena: konzola za eno kisikovo jeklenko in eno jeklenko za stisnjen zrak, z mehanizmom za hitro in tesno pritrnitev vsake posamezne jeklenke, dvizna delovna mizica z zatičem (enostavno rokovanje). Voziček mora vsebovati 5 predalov in izvlečno polico pod prvim predalom, od tega prvi nižji, s pregradami za zdravila, drugi za ampule, zadnji višji za steklenice. Predali: 1. predal višine 128 mm, s pregradami za zdravila 2. izvlečna mizica, 3. predal višine 128 mm, s pregradami za ampule 4. predal višine 128 mm, 5. predal višine 192 mm, 6. predal višine 192 mm, za infuzijske steklenice Opomba: višina predalov je okvirna (odvisna je od višine vozička) Predali vozička morajo biti opremljeni z lahkim vakuumskim mehanizmom, ki omogoča samostojno zapiranje predalov. Onemogočeno prevračanje vozička. Hrbtna stran vozička: 1. štiri (4) vtičnice za elektriko 2. reanimacijska deska, 3. konzola za držalo za inf. stojalo, z vključenim stojalom, 4. mrežasta košara za katetre, 5. mizica za defibrilator - 1 promikajoča polica za defibrilator (dimenzija police 300x220mm(+/- 2%)) nosilnost max 15 kg	

3	ODDELEK ZA ABDOMINALNO	VOZIČEK ZA PREVEZE IN POSEGE, večji, kirurški sektor	1 Material: aluminij in plastika ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), omogočati mora lahko in učinkovito čiščenje in razkuževanje. 2 Delovna površina mora biti iz ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) materiala ter ob straneh in zadaj naraščajoče dvignjena, zaradi varnega rokovanja z zdravili ter preprečitve polivanja tekočin pri transportu. Delovna površina mora biti zaobljene oblike, kar onemogoča nalaganje prahu in umazanje ter štiti pred udarci. 3 Zaščita pred poškodbami: voziček mora biti spodaj v celoti obdan z zaščito pred poškodbami, ki je široka toliko, da zajame ogrodje in ročaje zaprtih predalov (kot npr. Optiplan ali Hammerlit). V primeru trka mora biti onemogočena poškodba ogrodja, ročajev ali odstranitve barve vozička. 4 Dimenzije vozička: - Višina vozička s kolesi: 1000 -1050 mm; - Dolžina: 740 -780 mm, z zaščito pred poškodbami; - Širina: 500 - 590 mm, z zaščito pred poškodbami. 5 Ob strani vozička mora biti ročaj za pomikanje vozička 6 Voziček mora imeti štiri predale, in sicer: - dva nižja predala za drobni medicinski potrošni material, s pregradnimi stenami; - dva višja predala za razne sete in katetre, s pregradnimi stenami. 7 Voziček mora vsebovati štiri antistatična kolesa fi 100-125 mm, pomična v vse smeri, kolesa ne smejo puščati sledov ob stiku z drugimi materiali; dva kolesa z zavorami. 8 Ogrodje svetlo sivo, stranice vozička in ročaji v barvi po izbiri naročnika. 9. Voziček mora vsebovati: - Držalo za razkužilo (500 ml) - Držalo za 1 sc rokavic - Držalo za zabojnik za ostre predmete - 4x konzola za vrečke za odpadke (2x levo, 2x desno) - Na desni strani vozička izvlečna polica (krajša). Voziček mora imeti tudi možnost naknadne montaže stojala za tablični računalnik (na hrbtni strani). Vsi dodatki (držala, posode, košare,...) morajo biti narejeni tako, da omogočajo enostavno ročno čiščenje in razkuževanje	
4	kir.spec. amb.	MIZA INŠTRUMENTARSKA MAYO, mala	Voziček mora biti v celoti izdelan iz nerjavečega jekla, primerne za uporabo v bolnišničnem okolju ter odpornega na običajna sredstva za čiščenje in razkuževanje. * Globoko vlečna brezšivna polica z robom in zaobljenimi notranjimi vogali za enostavno čiščenje. * Ročna nastavitve višine. * Nastavitve višine: od 800 -1200 mm; * Stabilno podnožje s štirimi kolesi. Štiri antistatična vrtljiva kolesa, od tega najmanj dva z zavoro. * Premer koles najmanj 50 mm. * obremenitev najmanj 30 kg; * dimenzije police: 600-640 x 400-450 mm.	
5	COB	MIZA INŠTRUMENTARSKA MAYO, velika, za oper. dvorane	Voziček mora biti v celoti izdelan iz nerjavečega jekla, primerne za uporabo v bolnišničnem okolju ter odpornega na običajna sredstva za čiščenje in razkuževanje. * vrtljiva: -90° do + 90°; * globoko vlečna brezšivna polica; * integrirana oljna črpalka za nastavitve višine z ročico pedala; * nastavitve višine: od 960–1355 mm; * tri kolesa premera med 50-60 mm, oblika podnožja: Y; * obremenitev do 30 kg; * dimenzije police: 700-750 x 500-550 mm.	
6	COB	MIZA INŠTRUMENTARSKA DVONIVOJSKA (kot OR SPECIFIC, 427-ADJ)	Voziček mora biti v celoti izdelan iz nerjavečega jekla, primerne za uporabo v bolnišničnem okolju ter odpornega na običajna sredstva za čiščenje in razkuževanje. * nastavljiva po višini; * dimenzije 1220 x 760 x 740 - 1000 mm; * odstranljiva, po višini nastavljiva polica, dim. 1220 x 550 mm nad glavno polico in odlagalno polico pod glavno polico. * štiri kolesa, ki ne smejo puščati madežev, prednja kolesa so z zavoro * nosilnost polic: zgornja 70 kg, glavna 90 kg, spodnja 90 kg	

7	COB	VOZIČEK INOX, z dvema policama, mali, za prevoz oper.mrež in pripomočkov	Voziček mora biti v celoti izdelan iz nerjavečega jekla, primernega za uporabo v bolnišničnem okolju ter odpornega na običajna sredstva za čiščenje in razkuževanje. Dimenzije: * dolžina: 600- 650 mm * širina: 400 - 450 mm * višina: 800 - 850 mm (s kolesi) * 4 kolesa iz gume, ki ne smejo puščati sledi na tleh, vrtljiva 360° * z dvema snemljivima policama v razmaku cca 530 mm (odvisno od višine vozička) * nosilnost vozička min. 150 kg * voziček mora imeti ročko za potiskanje vozička po širini vozička, pod kotom in višino 20 cm * police morajo biti brez ograjic- poglobljene, globina od 3-5 cm.	
8	COB	PRUČKA NIZKA	Pručka mora biti v celoti izdelana iz nerjavečega jekla, primernega za uporabo v bolnišničnem okolju ter odpornega na običajna sredstva za čiščenje in razkuževanje. • nogice s protidrso podlogo/gumo • površina pručke ne sme drseti • višina 10-122 cm • širina 30-35 cm • dolžina 55-60 cm	
9	ABDOMINALNI, ŽILNI ODD.	VOZIČEK ZA NEGO, večji	običajna sredstva za čiščenje in razkuževanje. Delovna površina ravna, vogali zaobljeni, 2 Dimenzija vozička: - Višina s kolesi: 105 cm - Dolžina: 120 cm - Širina : 60 cm 3 Izgled: Voziček je razdeljen na dva dela, leva stran približno 55 cm, desna stran približno 30 cm. Večji del je opremljen s tremi policami, medtem ko ima manjši del eno polico. Voziček je z obeh čelnih strani zaprt z mrežo. Višina med policami približno 35 cm. Voziček na obeh bočnih straneh straneh ročaj za premikanje vozička. 4 Dodatna oprema vozička: • Večja mrežasta obešena košara, ki ima možnost premikanja (iztikanja) (dimenzije približno: dolžina 49 cm, višina 18 cm, širina 18cm). • Manjša mrežasta obešena košara, ki ima možnost premikanja (iztikanja) (dimenzije približno: Dolžina 25cm, višina 18cm, širina 18cm). Voziček mora imeti štiri antistatična kolesa fi 10-12,5 cm, pomična v vse smeri, kolesa ne smejo puščati sledov ob stiku z drugimi materiali; dva kolesi z zavorami. Voziček mora biti v celoti izdelan iz nerjavečega jekla, primernega za uporabo v bolnišničnem okolju ter odpornega na običajna sredstva za čiščenje in razkuževanje. * Zunanje dimenzije: 80x50x80 cm * 4 odbojna kolesa (fi 125 cm), ki ne smejo puščati sledi na tleh (2 kolesa z zavoro) * dve fiksne police * nosilnost vozička min. 100 kg * voziček mora imeti ročko za potiskanje vozička po širini vozička * police morajo ograjico/ojačan rob	
10	ŽILNI ODD., TRAVMA	VOZIČEK INOX (servirni voziček), s tremi policami, z ograjico	Voziček mora biti v celoti izdelan iz nerjavečega jekla, primernega za uporabo v bolnišničnem okolju ter odpornega na običajna sredstva za čiščenje in razkuževanje. * Zunanje dimenzije: 80x50x80 cm * 4 odbojna kolesa (fi 125 cm), ki ne smejo puščati sledi na tleh (2 kolesa z zavoro) * dve fiksne police * nosilnost vozička min. 100 kg * voziček mora imeti ročko za potiskanje vozička po širini vozička * police morajo ograjico/ojačan rob	
11	LEKARNA	VOZIČEK INOX - s tremi policami, ravna ploskev	Voziček mora biti v celoti izdelan iz nerjavečega jekla, primernega za uporabo v bolnišničnem okolju ter odpornega na običajna sredstva za čiščenje in razkuževanje. Dimenzije: * dolžina: 900 mm * širina: 600 mm * višina: 1000 mm (s kolesi) * 4 kolesa, ki ne smejo puščati sledi na tleh (2 kolesa z zavoro) * tri fiksne police, razmak med policami cca 360 mm (oz. odvisno od višine vozička, pomembno je, da je razmak med policami enak) * nosilnost vozička min. 200 kg * voziček mora imeti ročko za potiskanje vozička po širini vozička * police morajo imeti ravna ploskev	

12	LEKARNA	Voziček za prevoz plen in posteljnine	Izdelan iz jeklenih kromanih cevi. Ima tri police, je zložitljiv, kolesa dimenzije fi 125 mm z zavorami. Dimenzije: - širina: 1230 cm - dolžina: 630 cm - višina: 1700 cm	
	(ginek amb)	VOZIČEK INOX - s tremi policami, ojačan rob	Voziček mora biti v celoti izdelan iz nerjavečega jekla, primerne za uporabo v bolnišničnem okolju ter odpornega na običajna sredstva za čiščenje in razkuževanje. Dimenzije: * dolžina: 640-660 mm * širina: 420-450 mm * višina: 800-900 mm (s kolesi) * 4 kolesa, ki ne smejo puščati sledi na tleh (2 kolesa z zavoro) * tri fiksne police, razmak med policami enak * nosilnost vozička min. 100 kg * voziček mora imeti ročko za potiskanje vozička po širini vozička * police morajo biti brez ograjic- ojačan rob	
	(ginek amb)	VOZIČEK INOX - z dvema policama, ojačan rob	Voziček mora biti v celoti izdelan iz nerjavečega jekla, primerne za uporabo v bolnišničnem okolju ter odpornega na običajna sredstva za čiščenje in razkuževanje. Dimenzije: * dolžina: 640-660 mm * širina: 420-450 mm * višina: 800-900 mm (s kolesi) * 4 kolesa, ki ne smejo puščati sledi na tleh (2 kolesa z zavoro) * dve fiksne police * nosilnost vozička min. 100 kg * voziček mora imeti ročko za potiskanje vozička po širini vozička * police morajo biti brez ograjic- ojačan rob	
15	GINEKOLOGIJA	VOZIČEK Z OGREVANIM PREDALOM ZA INŠTRUMENTE	Mizica s predali za ginekološke inštrumente in odlagalno površino. Dimenzije: 625 x 995 x 530 mm (Š x V x G) Na kolesih za lažje premikanje. Zgornja površina iz kakovostnega ABS materiala, primerna za čiščenje in razkuževanje. na zgornji površini naj bodo dodatne odlagalne površine - 4 predelki za paličice, krtačke in brise. 4 predali enake velikosti za pregledno shranjevanje opreme Zgornji predal naj ima vgrajen sistem za ogrevanje spekulov in mora biti skladen z Direktivo o nizkonapetostni opremi 2014/35/EU. Digitalni prikaz temperature z enostavnim upravljanjem, temperatura nastavljava do 40 °C Prikaz časa in vgrajen časovnik za samodejni vklop in izklop Napajalni kabel z omrežnim vtikačem, dolžina približno 5 m	

16	NBO	VOZIČEK ZA ODVZEME KRVNI IN TERAPIJO	Material: Voziček mora biti v celoti izdelan iz nerjavečega jekla, primerneza za uporabo v bolnišničnem okolju ter odpornega na običajna sredstva za čiščenje in razkuževanje. • Delovne površine iz materiala, ki omogoča čiščenje in razkuževanje. • Delovna površine ravne, vogali zaobljeni, • Med zaščitno ograjico in delovno površino razmik, ki omogoča čiščenje in razkuževanje • Dimenzija vozička: - o Višina (H) s kolesi: 850 - 900 mm - o Širina (W): 400 - 450 mm - o dolžina (L): 450 - 500 mm • Voziček ima tri police z zaščitno ograjico okoli posamezne police. • Razmak med policami 300 mm. • Voziček ima na eni strani ročaj za premikanje vozička, na drugi strani pa predelno steno po celotni višini vozička. • Fiksna mrežna košarica nameščena pod ročajem za premikanje dimenzij (W x L x H) 400 x 140 x 100 mm • Mrežna košara za namestitve vrečke za odpadke dimenzij (W x L x H) 150 x 300 x 250 mm brez obešalnih kljukic • Stojalo za infuzijo z najmanj dvema krakima nastavljivo po višini • Na zgornji polici integrirano držalo oz. nosilec za razkužilo dimenzij (W x L x H) 100 x 100 x 100 mm • Držalo za posoda za infektivne odpadke nastavljivo po višini. Konstrukcija mora omogočati namestitvev za hrbtno stran vozička v višini, ki ne sega preko zgornje police • Štiri antistatična kolesa premera 100 mm, pomična v vse smeri, kolesa ne smejo	
----	-----	--------------------------------------	--	---