Lekarna Ljubljana
Komenskega ulica 11
1000 Ljubljana

T 01 2306 100
E lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si
www.lekarnaljubljana.si

Ljubljana, 16.11.2026
Številka: 4353-5/2026

Zadeva: Sprememba dokumentacije št. 4353-3/2026 z dne 23.10.2026

Zveza: Številka objave na PJN: **JN008460/2026-EUe16/01**, datum objave: 26.10.2026
Številka objave na TED: 739732-2026, datum objave: 26.10.2026

Predmet naročila: Nakup avtomatiziranih lekarniških sistemov skladiščenja s prinosom zdravil z vzdrževanjem

V dokumentaciji št. 4353-3/2026 z dne 23.10.2026 se **v 9. členu spremeni točka 18.**, in sicer:

namesto:

18. Ponudnik zagotavlja obratovanje z nizko porabo energije v celotnem času obratovanja. Poraba električne energije v fazi delovanja za avtomatiziran vnos in avtomatizirano skladišče skupno ne sme presegati 1,0 kWh. *Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec 5) in tehnična specifikacija obeh naprav iz katere nedvoumno in jasno izhaja, da skupna poraba ne presega 1,0 kWh*

beri:

18. Ponudnik zagotavlja obratovanje z nizko porabo energije v celotnem času obratovanja. Skupna nazivna električna moč avtomatiziranega vnosa in avtomatiziranega skladišča ne sme presegati 1,0 kW. ***Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec 5) in tehnični specifikaciji obeh naprav, iz katerih nedvoumno in jasno izhaja, da njuna skupna nazivna električna moč ne presega 1,0 kW.***

Skladno z navedeno spremembo se spremeni obrazec 5 in obrazec 2b. Naročnik objavlja nova obrazca 5 in 2b. V novem obrazcu 2b so označene tudi korekcije, ki izhajajo iz dosedanjih na portalu javnih naročil objavljenih pojasnil naročnika.
Ponudnik v ponudbi predloži obrazec 5 – nov in obrazec 2b – nov.

Sprememba št. 4353-5/2026 z dne 16.11.2026 je sestavni del dokumentacije št. 4353-3/2026 z dne 23.10.2026.

Direktor
Sašo Rink

Sašo Rink
Digitalno podpisal Sašo Rink
Datum: 2026.11.16 09:56:10 +01'00'

Obrazec 2b - nov

Ljubljana, 23.10.2026
Številka: 4353-3/2026
Ponudnik: _____
_____
_____

Sprememba RD: 4353-5/2026
(16.11.2026)

TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

SKLOP 1 - NAKUP SISTEMA

Nakup avtomatiziranih lekarniških sistemov skladiščenja s prinosom zdravil (v nadaljevanju: sistem), obsega:

- nakup in namestitve Glavnih sistemov in povezanih Dodatkov:
  - poličnih avtomatiziranih skladišč z eno robotsko roko ali dvema robotskima rokama, odvisno od razreda glavnega sistema (Glavni sistemi),
  - zunanjih ali notranjih popolnoma avtomatiziranih sistemov vnosa pakiranj zdravil z zunanjimi zbirnimi transportnimi trakovi (Dodatki št. 1),
  - transportnih sistemov in elementov do izdajnih mest (Dodatki št. 2),
  - prevzemnih pick-up terminalov za stranke (Dodatki št. 3),
  - sistemov za avtomatizirano podajanje zbirnih transportnih posod (Dodatki št. 4).
- implementacijo strojne in programske opreme ter povezave z naročnikovim informacijskim sistemom,
- usposabljanje lekarniškega osebja in pomoč pri prvih polnjenjih,
- vzpostavitev oziroma zagon glavnih sistemov in dodatkov.

Kot dokazilo mora ponudnik v ponudbi predložiti priloge iz katerih je razvidno, da blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika:

- opisi opreme/prospektni material/katalogi proizvajalca/tehnična dokumentacija v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku ali
- navodila za uporabo in morebitna zahtevana dokazila (certifikati) iz katerih bodo jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujenega blaga, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh naročnikovih strokovnih zahtev.

Dovoljeno je tudi dokazovanje s pomočjo posnetkov in fotografij. Izjemoma, če gre za specifiko sestava po zahtevah naročnika in določenih podatkov ni v tehnični dokumentaciji proizvajalca, naročnik dopušča predložitev izjave proizvajalca opreme.

Usposabljanje lekarniškega osebja in pomoč pri prvih polnjenjih/izdajah

Usposabljanje redne ekipe lekarne bo potekalo v treh fazah:

1. *faza usposabljanja*

   Traja okvirno 4 ure in se 2 - 3 tedne pred pričetkom namestitve novega sistema v lekarni lahko izvaja v prostorih izvajalca ali v prostorih naročnika. Usposabljanje je uspešno zaključeno, ko vsak udeleženec usposabljanja opravi pisni in praktični test pripravljen s strani izvajalca. Izvajalec v fazi predpriprave na usposabljanje pripravi ustrezno gradivo (video posnetke, pisna navodila, navodila in ostale informacije dostopne preko spleta, ….) Predpriprava je za vse udeležence obvezna.

2. *faza usposabljanja*

Organizira se 2 - 3 dni pred odprtjem lekarne na nameščenem sistemu v lekarni v najmanj 2 skupinah, vsaka po 2 uri. Hkrati se izvaja pomoč pri prvih polnjenjih/izdajah.

3. *faza usposabljanja*

Dva do tri delovne dni od odprtja lekarne bo z redno ekipo lekarne 3 ure prisotna strokovna oseba izvajalca, da pomaga utrditi sposobnost redne ekipe lekarne za samostojno upravljanje oz. uporabo sistema.

A. Opis in zahteve avtomatiziranih skladišč (Glavnih sistemov):

GENERALNE ZAHTEVE ZA POSAMEZNI GLAVNI SISTEM

Omogočati mora:

- krajše nadgradnje in posodobitve,
- spremljanje temperature in vlage v notranjosti avtomatiziranih skladišč, ki jih izvede hišni izvajalec naročnika,
- hlajenje glavnih sistemov s priklopi na klimatske sisteme lekarn, s katerim se zagotavlja ustrezna temperatura v skladiščih (od 15 do 25 stopinj C) in jih izvede hišni izvajalec naročnika.
- funkcionalnost hkratnega in sočasnega delovanja ročnega vnosa (polaganje pakiranj na mesto za ročni vnos zdravil) ter izdaje z izskladiščenjem zdravil,
- da bodo pakiranja zdravil takoj po vnosu v glavne sisteme že dosegljiva za izdajo (v času 5 s od odlaganja na vnosni trak ali odlagalno poličko modula za polavtomatski vnos).
- da se ob skladiščenju roki uporabnosti avtomatično prevzamejo iz elektronske dobavnice preko lekarniškega informacijskega sistema,
- enovito delovanje dveh ali več glavnih sistemov z dodatki postavljenih v eni lekarni.
- pri več sočasno prejetih naročilih mora sistem zagotavljati njihovo izmenično obdelavo, tako da veliko naročilo ne blokira obdelave manjših naročil, prejetih na drugih izdajnih mestih (naročnik si pridržuje pravico ogleda delovanja nameščenega sistema v kateri izmed lekarn – ponudnik organizira ogled).

Imeti mora:

- kaotičen princip skladiščenja: pakiranja se na police zlagajo čim bolj optimalno glede na obstoječi skladiščni prostor,
- že pripravljen koncept skladiščenja zdravil po FEFO metodi (First Expired – First Out): izskladišči se najprej pakiranja z najkrajšim rokom uporabnosti,
- višino med 2,40 m in 3,50 m (naročnik bo ob izvedbi projekta navedel točno možno višino sistema, ponudnik mora biti sposoben ponuditi sistem v maksimalnem odstopanju višine od idealne višine ±5 cm),
- 1 modul za hitri ročni vnos pakiranj s čitalcem 2D črtnih kod na stranici, kjer se sistem upravlja,
- največ 1 vhodna vrata za osebje in serviserje na stranici, kjer se sistem upravlja tudi za sisteme z dvema robotskima rokama,
- 1 osnovno izhodno mesto na stranici, kjer se sistem upravlja, za direktno izskladiščenje pakiranj,
- čistilni modul za avtomatsko čiščenje polic min. 2x mesečno (naročnik si pridržuje pravico ogleda delovanja nameščenega sistema v kateri izmed lekarn – ponudnik organizira ogled),

- ročni vnos pakiranj z modulom za hitri ročni vnos s sposobnostjo ročnega vnosa enega pakiranja v času do 5 sekund, sposobnost izskladiščenja 4 pakiranj v času do 9 sekund na eno direktno izdajno mesto v oficini (čas izskladiščenja se šteje od trenutka začetka premika robotske roke) – priloži se dokazni posnetek,
- možnost delovanja na enofazni izmenični napetosti 230V,
- vgrajen vmesnik proizvajalca avtomatiziranega lekarniškega skladišča za odčitavanje in dekodiranje edinstvene oznake v obliki 2D črtne kode zdravil v sistemu zagotavljanja avtentičnosti in varnosti zdravil skladen z nacionalnim informacijskim sistemom za preprečevanje vstopa ponarejenih zdravil Zavoda za preverjanje avtentičnosti zdravil,
- ponastavljanje razmika med policami, odstranjevanje polic in dodajanje novih polic z namenom optimizacije kapacitete ob spremembah strukture velikosti pakiranj, katere izvajalec lahko po potrebi prilagodi ob rednih vzdrževalnih obiskih na enostaven način v primeru sprememb velikosti novih pakiranj,
- ~~direktno izskladiščenje na vse štiri stranice avtomatiziranega sistema brez uporabe transportnih trakov, drč in spiral~~ sistem mora omogočati izvedbo izhodnih mest na kateri koli od štirih stranic, neposredno ali prek transportnih rešitev. Dejanski položaj in število izhodnih mest se določita glede na projekt posamezne lekarne *(*pojasnilo portal)*,
- obratovanje z nizko porabo energije v celotnem času obratovanja. Skupna nazivna električna moč avtomatiziranega vnosa in avtomatiziranega skladišča ne sme presegati 1,0 kW, *(SPREMEMBA RD 4353-5/2026)*
- nivo hrupa, ki ga skupno povzročata sistem za avtomatiziran vnos in avtomatizirano skladišče, ne presega 53 dB na delovnem mestu

  Ponudnik poda uradne tehnične dokumente proizvajalca za dokazovanje glasnosti avtomatiziranega skladišča in avtomatiziranega vnosa. Hkrati poda izračun skupne glasnosti sistemov po enačbi:

  $$L_{skupaj} = 10 \log_{10} \left(10^{L_1/10} + 10^{L_2/10} \right)$$

- avtomatizirano skladišče mora imeti možnost instalacije hladilne enote
- integrirana programska podpora sistema omogoča pregled zaloge zdravil po mesecih zapadlosti roka uporabe, zasedenosti sistema po strukturi velikosti pakiranj, hitro izdajo serije zdravil v primeru odpoklica zdravila.
- možnost namestitve dodatnega modula za ročni vnos
- širina za prehajanje osebja ali serviserjev med regali na katerih so pakiranja vsaj 80 cm.
- dostop do elektro omarice avtomatiziranega skladišča z varovalkami komponent mora biti omogočen na sprednji krajši stranici brez vstopa v sistem.

Dimenzije pakiranj s katerimi lahko sistem upravlja so:

- Minimalna velikost pakiranja do vključno 35 mm x 20 mm x 15 mm (globina/širina/višina)
- Maksimalna velikost pakiranja od vključno 220 mm x 130 mm x 120 mm (globina/širina/višina)

Poleg generalnih zahtev morajo v 4 razrede razvrščeni glavni sistemi zagotavljati naslednje:

Glavni sistem razreda 1 mora imeti oz. zagotavljati:

- kapaciteto skladiščenja med 7.000 in 11.000 pakiranj zdravil različnih dimenzij
- 1 elektronsko vodeno robotsko roko,
- do 3 izhodna mesta do direktnih izhodov in/ali transportnih trakov,

Glavni sistem razreda 2 mora imeti oz. zagotavljati:

- kapaciteto skladiščenja med 11.000 in 15.000 pakiranj zdravil različnih dimenzij
- 1 elektronsko vodeno robotsko roko,
- do 4 izhodna mesta do direktnih izhodov in/ali transportnih trakov,

Glavni sistem razreda 3 mora imeti oz. zagotavljati:


- kapaciteto skladiščenja med 15.000 in 17.500 pakiranj zdravil različnih dimenzij
- 2 elektronsko vodeni robotski roki,
- zahtevan čas izskladiščenja je zmožna zagotoviti vsaka od dveh robotskih rok za izskladiščevanje tudi v primeru nedelovanja ene izmed rok,
- vsaka izmed robotskih rok je zmožna streči vsa izdajna mesta,
- do 5 izhodnih mest do direktnih izhodov in/ali transportnih trakov,

Glavni sistem razreda 4 mora imeti oz. zagotavljati:

- kapaciteto skladiščenja med 17.500 in 30.000 pakiranj zdravil različnih dimenzij
- 2 elektronsko vodeni robotski roki,
- zahtevan čas izskladiščenja je zmožna zagotoviti vsaka od dveh robotskih rok za izskladiščevanje tudi v primeru nedelovanja ene izmed rok,
- vsaka izmed robotskih rok je zmožna streči vsa izdajna mesta,
- do 7 izhodnih mest do direktnih izhodov in/ali transportnih trakov.

B. Vzpostavitev Glavnih sistemov obsega:

- implementacijo strojne in programske opreme ter povezavo z lekarniškim programom Orka.aor in Vmotion virtualnimi policami na način kot ga prikazuje skica (povezava med Orka.AOR in Vmotion že obstaja):

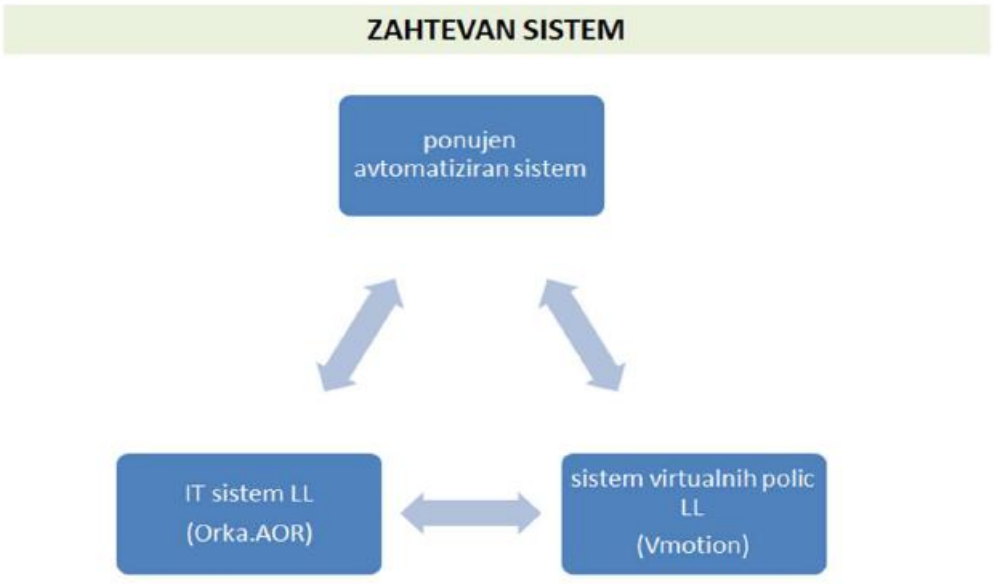

- vzpostavitev oziroma zagon sistema s testiranjem delovanja,
- tehnično dokumentacijo,
- usposabljanje lekarniškega osebja in pomoč pri prvem polnjenju,
- navodila za rokovanje s sistemi v slovenskem jeziku.

C. Zahteve za varnostni paket Glavnih sistemov so:

- elektronske meritve vsakega posameznega pakiranja in avtomatska primerjava izmerjene dimenzije z dimenzijami shranjeni v podatkovni bazi z enako črtno kodo (dvojna kontrola),
- dodaten računalnik za povečanje varnosti in razpoložljivosti sistema zaradi izpadov,
- stalno dodatno varovanje podatkov »back-up« (na zunanjem nosilcu podatkov),
- brezprekinitveno električno napajanje (UPS) z avtonomijo delovanja min 20 minut,
- neprekinjena oddaljena pomoč s strani serviserjev,
- elektronski varnostni nadzor, kar pomeni konstantni videonadzor delovanja robotske roke, ki skupaj s sistemom elektronsko nadzira delovanje naprave tako, da sam avtomatsko zaznava napake in s tem še dodatno zmanjšuje število prekinitev sistema,
- vnos in iznos pakiranj tudi v primerih izpada lekarniškega programa.

D. Opis in zahteve za Dodatke (1 – 4)

Ponudba mora poleg ponujenih Glavnih sistemov vsebovati tudi ponudbo dodatnih sistemov oz. t.i. Dodatkov, ki so kompatibilni in povezljivi z Glavnimi sistemi.

Dodatek 1 - Popolnoma avtomatiziran sistem vnosa – zunanji ali notranji mora imeti:

- sposobnost vskladiščenja 310 pakiranj na uro.
- zunanji zbirni vnosni trak v katerega se vsujejo pakiranja:
  - dolžina zunanjega zbirnega vnosnega traku ob Glavnem sistemu razreda 2 je 2,0 m
  - dolžina zunanjega zbirnega vnosnega traku ob Glavnem sistemu razreda ~~4~~ 3* je 3,0 m *(*pojasnilo portal)*
  - dolžina zunanjega zbirnega vnosnega traku ob Glavnem sistemu razreda ~~3~~ 4* je 4,0 m *(*pojasnilo portal)*
- minimalna kapaciteta dolžine 1 m zbirnega vnosnega traku 230 pakiranj
- sposobnost upravljanja pakiranj dimenzij:
  - minimalna velikost pakiranja do vključno 35 mm globina x 20 mm širina x 15 mm višina,
  - maksimalna velikost pakiranja od vključno 220 mm globina x 130 mm širina x 120 mm višina,
- sposobnost upravljanja pakiranj teže:
  - minimalna teža pakiranja do vključno 10 g
  - maksimalna teža pakiranja od vključno 750 g,
- možnost delovanja na enofazni izmenični napetosti 230V ali trifaznem napajanjem 400 V *(*pojasnilo portal)*,
- povezljivost z Glavnim sistemom preko WWKS2 komunikacijskega vmesnika za potrebe povezovanja z lekarniškim informacijskim sistemom Orka.AOR naročnika,
- možnost servisiranja sistema brez zaustavitve Glavnega sistema.

Dodatek 2 - Transportni sistemi:

Dodatek 2.1 Transportni trakovi

- transportni trak lahko dosega hitrost 1,5 m/s,
- možnost delovanja na enofazni izmenični napetosti med 210 in 230V.
- možna maksimalna dolžina traku vsaj 9 m
- lahko obratuje z glasnostjo manjšo od 56 dB

Dodatek 2.2: Transportni polži

- zunanji premer transportnih polžev maksimalno 40 cm.

Dodatek 2.3: Direktni izhodi

- odprtina enega direktnega izhoda v retropultu v oficini, ki pripada določeni delovni postaji oz. izdajnemu mestu, ne sme odvzeti vertikalno več kot 35 x 30 cm (širina X višina) površin predstavitvenih polic za izdelke.

Dodatek 3 – Prevzemni »Pick-up« terminal za prevzem prednaročenih in predplačanih izdelkov – zunanji

Mora imeti:

- možnost namestitve skozi steno z upravljanjem na zunanji strani lekarne za namen 24-urnega prevzema izdelkov lekarne,
- dimenzije na zunanji strani stene maksimalno 80cm širine x 210cm višine,
- vgrajen čitalec 2D črtnih kod,
- vgrajen ekran na dotik minimalne velikosti 15”, s sposobnostjo odčitavanja ob direktni sončni svetlobi,
- vgrajeno revizijsko loputo za primere nujnih ročnih predaj izdelkov,
- vgrajen prevzemni predalnik s signalno lučko (pripravljeno za prevzem),
- vgrajeno varno zbirno mesto za ne-prevzete predmete,
- prednja stran mora biti iz brušenega nerjavečega jekla (V2A), zaščitena pred korozijo / C2 DIN EN ISO 12944,
- povezljivost z Glavnim sistemom preko WWKS2 komunikacijskega vmesnika za potrebe povezovanja z lekarniškim informacijskim sistemom Orka.AOR ter spletno lekarno naročnika,
- možnost delovanja na enofazno izmenično napetost med 210 in 230V,
- razred odpornosti proti vlomu v skladu s standardom RC3 po DIN EN 1627,
- toplotno zaščito v skladu s standardom DIN 4108-2.
- stopnja zaščite IP 44
- domofonski sistem za zvočno komunikacijo z vgrajeno osvetljeno tipko za zvonec,
- Opcijski paket za zvočno komunikacijo z dežurno službo:
    - funkcija za sprotni prikaz informacij o dežurnih lekarnah glede na lokacijo terminala.
    - Sistem mora imeti vgrajeno oziroma integrirano opremo za dvosmerno zvočno komunikacijo med uporabnikom terminala in osebjem lekarne preko IP-omrežja (VoIP), vključno z vsemi potrebnimi komponentami za vzpostavitev govorne povezave.

Dodatek 4 – Sistem za avtomatizirano podajanje zbirnih transportnih posod:

- lahko upravlja z zbirnimi posodami dimenzije
    - širine od 280 mm do vključno 360 mm,
    - višine do vključno 310 mm,
    - dolžine od vključno 340 do vključno 500 mm,
- je sposoben izdati/podati 140 zbirnih transportnih posod na uro,
- lahko naenkrat hrani vsaj 80 zbirnih posod,
- možnost delovanja na enofazni izmenični napetosti med 210 in 230V,
- transportni sistem s točko za izskladiščenje pakiranj v zbirne posode dolžine do 4,0 m,
- povezljivost z Glavnim sistemom preko WWKS2 komunikacijskega vmesnika za potrebe povezovanja z lekarniškim informacijskim sistemom Orka.AOR naročnika.

SKLOP 2 - VZDRŽEVANJE AVTOMATIZIRANIH LEKARNIŠKIH SISTEMOV SKLADIŠČENJA S PRINOSOM ZDRAVIL ZA OBDOBJE 60 MESECEV

Pavšal za vzdrževanje Glavnega sistema in Dodatkov, ponujenih v Sklopu 1, za obdobje 5-ih let od primopredaje mora zajemati:

- tedenski nadzor vseh parametrov sistemov na daljavo,

- najmanj dva preventivna obiska na leto,
- neprekinjeno 24 urna telefonska pomoč,
- odzivni čas na lokaciji: 24 ur,
- garancijsko dobo vsaj 12 mesecev, upoštevaje zahteve slovenske zakonodaje,
- vse zamenjave oziroma iztrošeni deli in vse servisne ure, vključno z obiski, stroški, itd.,
- tehnične izboljšave, ki so običajne pri dobavi novih sistemov,
- sistem mora imeti možnost kasnejše nadgradnje z opremo istega ali drugega proizvajalca,
- posodobitve programske opreme, ki je na voljo s strani proizvajalca,
- najmanj eno brezplačno izobraževanje z dodatnimi vsebinami po testnem zagonu sistema.

Ponudnik v ponudbi predloži tehnični opis in katalosko/slikovno gradivo v ponudbi ponujenega sistema.

Referenčne lekarne

Naročnik si pridružuje pravico, da tehnične zmožnosti sistemov in dodatkov, ki jih je ponudnik podal v ponudbi, preveri pri referenčnih naročnikih (preveri njihovo delovanje na lokaciji).

Ponudnik v spodnji tabeli navede referenčne lekarne, ki uporabljajo v ponudbi ponujene sisteme in dodatke. Za vsako navedeno lekarno, ki uporablja v ponudbi ponujeno avtomatizirano skladiščenje in iznos zdravil, v spodnjo tabelo vpiše, kateri od zahtevanih dodatkov je v tej lekarni nameščen.

Naziv in naslov lekarne	Kontakt	Dodatek 1 (da/ne)	Dodatek 2 (da/ne)	Dodatek 3 (da/ne)	Dodatek 4 (da/ne)

Naziv in naslov lekarne	Kontakt	Dodatek 1 (da/ne)	Dodatek 2 (da/ne)	Dodatek 3 (da/ne)	Dodatek 4 (da/ne)

Ponujena rešitev zadostuje samo v primeru, ko je v stolpcih dodatkov od 1 do 4 za vsak dodatek posebej vsaj en odgovor »da«.

S podpisom teh tehničnih zahtev naročnika potrjujemo, da smo z njimi seznanjeni in da smo jih dosledno upoštevali pri pripravi ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za nakup avtomatiziranih lekarniških sistemov skladiščenja s prinosom zdravil z vzdrževanjem za naročnika Lekarna Ljubljana.

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

_____

V _____, dne _____

Obrazec 5 - nov

Ljubljana, 23.10.2026
Številka: 4353-3/2026

Sprememba RD: 4353-5/2026
(16.11.2026)

Ponudnik: _____

_____

_____

IZJAVA PONUDNIKA
o izpolnjevanju pogojev iz 18. do 20. točke 9. člena
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 4353-3/2026, z dne 23.10.2026

Izjavljamo da:

(18.) ponujena oprema obratuje z nizko porabo energije v celotnem času obratovanja in skupna nazivna električna moč avtomatiziranega vnosa in avtomatiziranega skladišča ne presega 1,0 kW, kar izkazujemo s podpisom te izjave in priloženima tehničnima specifikacijama obeh naprav; *(SPREMEMBA RD 4353-5/2026)*

(19.) zagotavljamo možnost delovanja na način, da nivo hrupa, ki ga skupno povzročata sistem za avtomatiziran vnos in avtomatizirano skladišče, ne presega 53 dB na delovnem mestu, ki se nahaja v prostoru ob glavnem sistemu, kar izkazujemo s podpisom te izjave in priloženo tehnično specifikacijo;

(20.) prevzemni »pick-up« terminal zadostuje zahtevam naročnika:
- prednja stran je iz brušenega nerjavečega jekla (V2A), zaščitena pred korozijo / C2 DIN EN ISO 12944,
- razred odpornosti proti vlomu v skladu s standardom RC3 po DIN EN 1627,
- toplotna zaščita v skladu s standardom DIN 4108-2,
- stopnja zaščite IP 44,

kar izkazujemo s podpisom te izjave in priloženo tehnično specifikacijo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za nakup avtomatiziranih lekarniških sistemov skladiščenja s prinosom zdravil z vzdrževanjem za naročnika Lekarna Ljubljana.

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

V _____, dne _____
_____

PONUDNIK, TAKO KOT JE OPREDELJENO V 9. ČLENU NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, K IZJAVI PRILOŽI TUDI TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IZ KATERE NEDVOUMNO IN JASNO IZHAJA IZPOLNJEVANJE RAZPISNIH POGOJEV IZ 18., 19. IN 20. TOČKE 9. ČLENA NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE.